

Coronapas-app

Step by step – Kontrollørguide

Indhold

Introduktion

1. Sådan kontrolleres et coronapas
2. Kontrol med scanner

Coronapas Danmark


5. Gyldigt coronapas i Danmark
6. Ugyldigt coronapas i Danmark

Coronapas Udlandsrejse

7. Visning af coronapas i udlandet

Andet


8. Hjælp og support

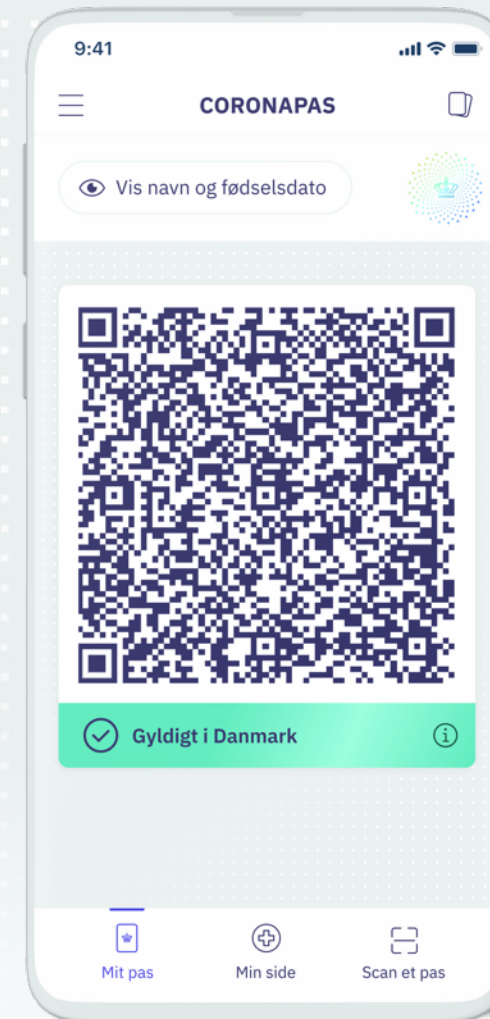

Introduktion

Det nye coronapas giver dig som kontrollør mulighed for:


1. At godkende et coronapas ved at se på det; der vil være en grøn bjælke, hvori der står 'Gyldigt i Danmark'
2. At scanne coronapas via en QR-kode og ad den vej godkende gyldige coronapas

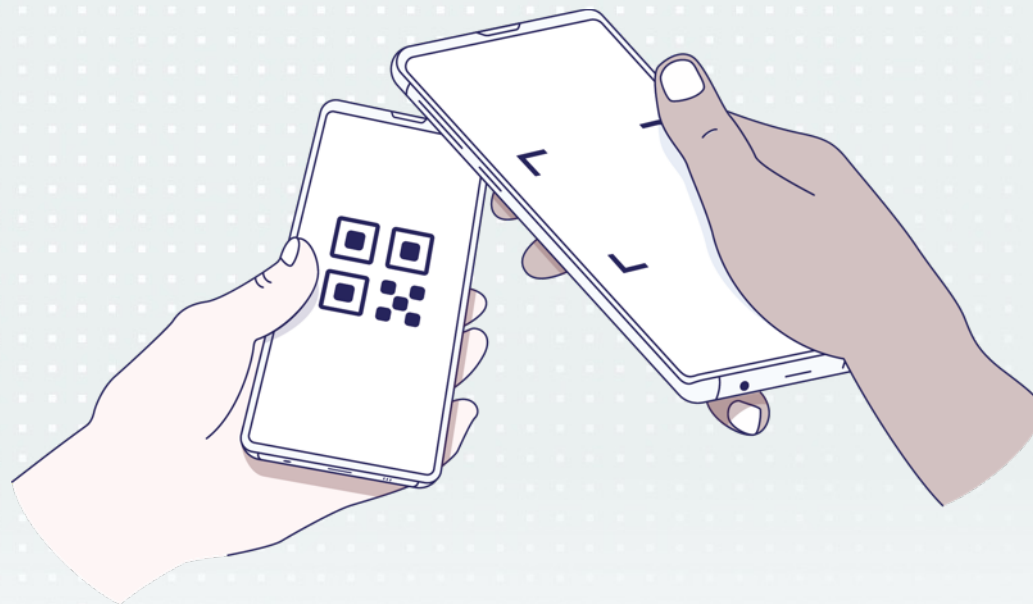

Hent Coronapas-appen i AppStore eller GooglePlay.

Sådan kontrolleres et coronapas

Coronapasset kan kontrolleres på to måder.

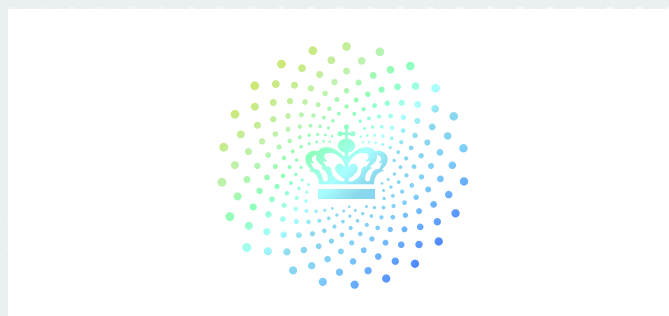


1. Visuel inspektion, hvor du ser efter vandmærkeeffekten i konge-kronen og i den grønne bjælke når telefonen bevæges

Hvis et coronapas er gyldigt, vil der stå 'Gyldigt i Danmark'.



2. Scan den synlige QR-kode med din scanner

Scan QR-koden. Hvis et coronapas er gyldigt, kan du se et bånd, hvor der står 'Gyldigt' på din mobiltelefon eller dit scanningsudstyr.

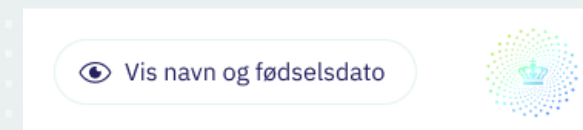

Appen kan blive vist både med og uden navn og fødselsdato. Der stilles ikke krav til visning af ID, når appen bruges, og derfor behøver brugeren ikke vise navn og fødselsdato.


Gyldigt coronapas i Danmark

Du kan genkende et gyldigt coronapas på vandmærkeeffekten i den grønne bjælke, hvori der står 'Gyldigt i Danmark' og i kongekronen eller via scannerfunktionen. Myndighederne stiller ikke krav til, hvilken kontrolmetode, der anvendes.

Kontrol af gyldighed vha. vandmærkeeffekt og 'Gyldigt i Danmark'




**Coronapas
anonymiseret**

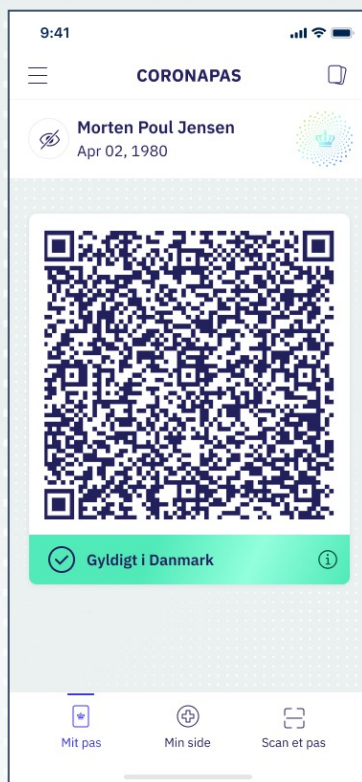

**Coronapas
med personinfo**

Kontrol af gyldighed vha. gyldigt scanningsresultat

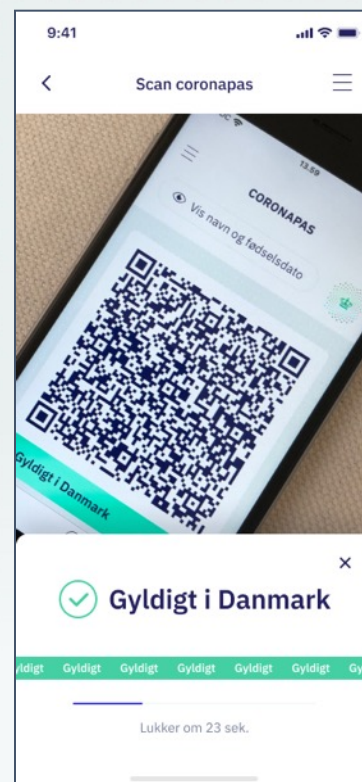


**Scanningsresultat
anonymiseret**

Ugyldigt coronapas i Danmark


Hvis personen ikke har et gyldigt coronapas, vil QR-koden enten mangle, eller scanningsresultatet vil melde udløbet eller ugyldigt.

Coronapas ikke klar

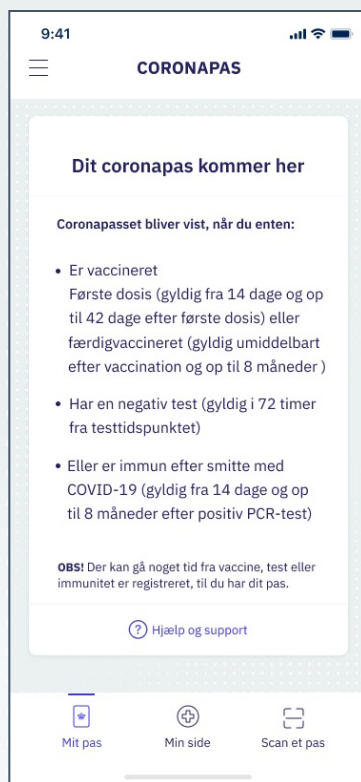


Hvis brugeren ikke har opfyldt nogen krav for at have et gyldigt coronapas, er der intet coronapas at vise.

Coronapas på vej

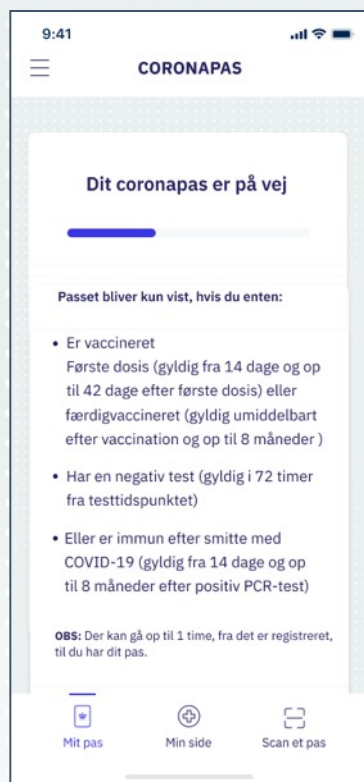

Hvis brugeren lige er blevet testet, kan der gå noget tid før resultatet bliver registreret i appen.

Scanningsresultat Coronapas udløbet

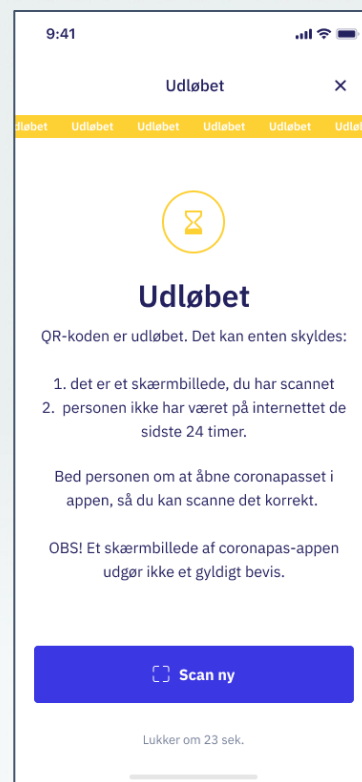

Hvis QR-koden er udløbet, fx hvis det er et skærbillede af en gammel QR-kode, vil scanningsresultatet være 'Udløbet'. Du skal bede brugeren om at vise deres aktive coronapas i appen.

Scanningsresultat Coronapas ugyldigt



Hvis QR-koden er uægte, fx hvis det er en QR-kode fra en anden app, vil scanningsresultatet være 'Ugyldigt'. Du skal bede brugeren om at vise deres aktive coronapas i appen.


Udlandsrejse

Hvis en person skal til udlandet, skal visningen 'Udlandsrejse' bruges.


Udlandsrejsevisningen er på engelsk og skal KUN anvendes ved ind- og udrejse til andre lande.

Coronapas

Klik på ikonet med passet i højre hjørne for at skifte til visningen *Udlandsrejse*

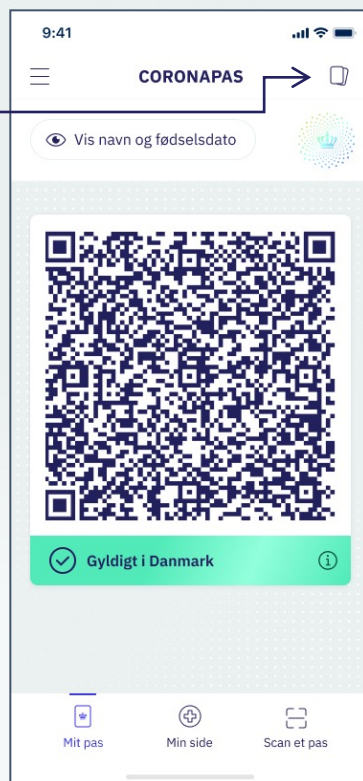

Udlandsrejse-visning

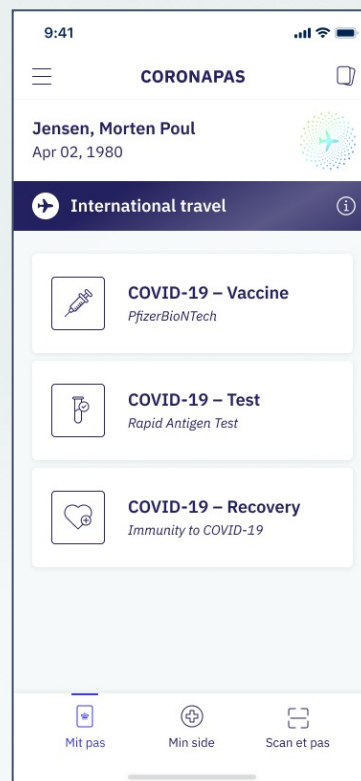

Coronapas til ind- og udrejse

- Man kan skifte mellem to visninger af coronapasset: Danmark og Udlandsrejser.
- Som kontrollør skal du: Bede personen om 1) at trykke på det lille ikon af et pas oppe i øverste højre hjørne og 2) vælge visningen *Udlandsrejse* 3) Hvis personen har flere gyldige resultater, skal du bede personen vælge det resultat, du vil kontrollere (enten vaccination, test eller tidligere smittet med COVID-19).
- Bemærk at der står 'International Travel' i stedet for 'Gyldig i Danmark'

Klik på det resultat som skal tjekkes

Udlandsrejse – gyldige visninger

Her ses eksempel på visning af en gyldig vaccine og visning af en gyldig test.

Resultatvisning - Vaccine

9:41

✕

Jensen, Morten Poul
Apr 02, 1980



 International travel

 **COVID-19 – Vaccine**
PfizerBioNTech

MARKETING AUTHORISATION HOLDER
PfizerBioNTech

DOSE 1 OF 2 BATCH NUMBER
Aug 16, 2021 5685

DOSE 2 OF 2	BATCH NUMBER
Feb 16, 2021	5685

TYPE	VACCINE NUMBER
COVID-19-mRNA	1119349007

VACCINE PRODUCT NAME
COMIRNATY concentrate for dispersion for injection

VACCINATION COUNTRY
Danmark

ADMINISTERING CENTRE(S) NAME
Lene Hansen, Herlev og Gentofte Hospital. Medicinsk overafd. C, GE

Certificate

CERTIFICATE ISSUER
The Ministry of Health

CORONA PASSPORT NUMBER
PF12345678

Resultatvisning - Test

9:41

✕

JENSEN, SOEREN POUL
Apr 2, 1980



 International travel

 **COVID-19 – Test**
Rapid Antigen Test

RESULT OF THE TEST
Negative

TYPE OF TEST
Rapid Antigen Test

DATE OF TEST SAMPLE COLLECTION	TIME OF TEST SAMPLE COLLECTION
Mar 20, 2021	8:10 PM

DATE OF TEST RESULT PRODUCTION	TIME OF TEST RESULT PRODUCTION
Mar 20, 2021	8:10 PM

TEST NAME
?

TEST MANUFACTURER
Biosynex Swiss SA, Biosynex COVID-19, Ag BSS

DISEASE
COVID-19

TESTCENTER
Falck...

MEMBER STATE OF VACCINATION
Denmark

Hjælp og support

Har du behov for hjælp kan du kontakte vores support på en af følgende muligheder:

Tekniske spørgsmål

Har du tekniske spørgsmål til appen, skal du kontakte supporten hos sundhed.dk på:

Email: coronapas.app@sundhed.dk

Telefon: +45 32 42 03 03

Spørgsmål vedr. anvendelse og regler

Har du spørgsmål vedr. anvendelse og regler ifm. kontrol, skal du kontakte Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på:

Telefon +45 72 20 00 34

Åbent: 8.30-16.00 (fredag dog 9.00-15.00)